



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Estado de Minas Gerais

Administração 2017/2020

## AVISO DE RETIFICAÇÃO

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 551/2019**

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 054/2019**

**OBJETO:** Locação de aparelhos BIPAP e CPAP, para uso de pacientes da rede municipal de saúde, que necessitam de tratamentos específicos com estes equipamentos, em conformidade com o Termo de referência.

Após análise das impugnações apresentadas pelas empresas Air Liquide e White Martins, fazem-se as seguintes retificações:

- A empresa vencedora deverá instalar o equipamento no domicílio dos pacientes, no prazo máximo de 72 horas, sendo que os mesmos deverão receber orientação e treinamento quanto ao uso.

- O item 01 Locação de aparelho Bilevel, passa a ter a seguinte descrição: **Aparelho Bilevel BIPAP: com tempo inspiratório 0,5 à 4 segundos, pressões: IPAP; 3 a 30 cmH2O, EPAP: 3 à 25 cm H2O, modos ventilatórios: CPAP, espontâneo, assistido, controlado. Alarmes ajustáveis: fuga, desconexão de máscara, volume minuto, pressão alta, pressão baixa. Acompanha traquéia e máscara nasal ou facial com suporte e fixação, em silicone natural, no tamanho adequado a cada paciente ou ainda válvula exalatória e cateter mount nos casos de pacientes traqueostomizados. Com bateria interna e/ou externa com durabilidade de 06 a 08 horas e, umidificador acoplado aquecido.**

- O item 02 Locação de aparelho CPAP, passa a ter a seguinte descrição: **CPAP FIXO/AUTOMÁTICO: Nível de Ruído: 24 dB; Intervalo de pressão: 4 a 20 cmH2O; Define pressão fixa somente no modo fixo; Define Pressão Automática; Rampa: 0 a 45 min. (incrementos de 5 min.); Compensa vazamento; Alívio de pressão: APE com Easy-Breathe; Medidas (AxLxC): 8,5 cm x 14**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMBUÍ

Estado de Minas Gerais

Administração 2017/2020

**cm x 15 cm; Requisitos elétricos: 100–240V, 50–60Hz; 115V, 400Hz (nominal para uso em aeronave); Voltagem: 100 V – 240 V (Bivolt); Consumo de energia: Típico: 70W (80 VA) e Máximo: 110W (120 VA); Cartão SD Armazenamento de Dados: Completo (IA, IH, IAH, IAC, Fuga, LF, Pressão, Horas de uso); Compensação de altitude: Automática; Auto ON/OFF.**

**Itens Inclusos:**

**Umidificador acoplado aquecido**

**Tubo (traqueia) SlimLine 2m**

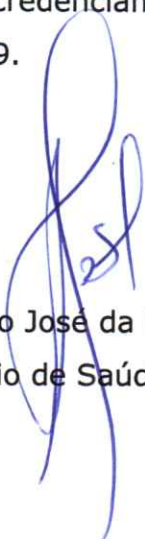
**Cartão de dados SD (1GB de memória)**

**Cabo de energia, Fonte de energia**

**Manuais em português, Máscara.**

Diante da presente retificação, altera-se o credenciamento e a abertura do certame para às 09 horas do dia 17 de junho de 2019.

  
Antonio Carlos Barbosa  
Pregoeiro

  
Sebastião José da Rosa Filho  
Secretário de Saúde